

ユーザー様 各位

令和 8 年 2 月 26 日
デンタルシステムズ株式会社

謹啓

貴医院におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
バージョンアップ作業を実施しておりますのでお知らせいたします。

お問い合わせ先

サポートセンター 電話番号 **050-5538-5452**
e-mail ds-desk@dentalsystems.jp

月末月初は電話が混み合う場合がありますが、留守番電話に繋がりますのでお名前と電話番号をお残してください。
折り返しご連絡申し上げます。また、ご質問はメールでも受け付けしております。
順次返答させていただきますので、少々お時間をいただくこともございますがご活用ください。

謹白


< バージョン 3.04.00 (0002) 変更一覧 >

【令和 8 年 3 月～】の診療報酬改定に対応 令和 8 年 3 月からの「『特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について』の一部改正について」について対応。	全国
入カマスターを更新 各種電算マスターと「医薬品マスター」「郵便番号マスター」「保険者マスター」を最新のマスターに更新。	全国
機能追加/不具合修正 新機能の追加と不具合の修正を行いました。詳細は『POWER5G バージョンアップ詳細』をご参照ください。	全国

<機能追加・不具合修正>

オンライン資格確認

医療扶助のオンライン資格確認において、資格有効性の値が「6：有効(未登録)」であった場合、オンライン資格確認情報画面の資格有効性欄が空欄となり、情報が表示されない不具合を修正。

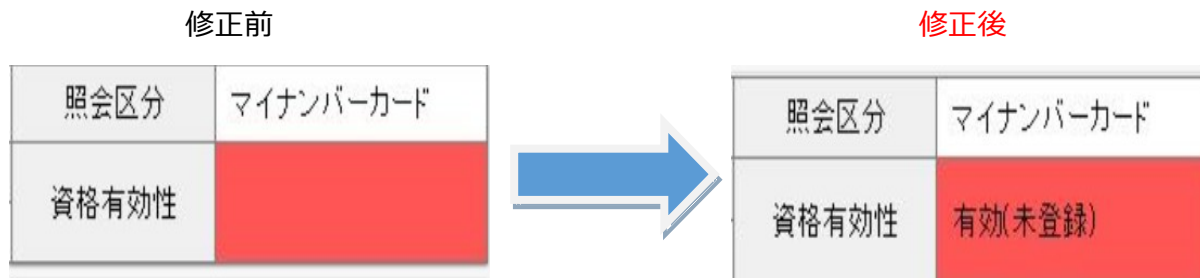

※「6：有効(未登録)」とは……以下3パターンのいずれかに該当する場合

1. 福祉事務局で登録された委託先の医療機関ではない。
(有効な医療券・調剤券情報は存在するが、委託先医療機関コードが一致しない)。
2. 無効(委託されていたが、有効期間が過ぎている(当月有効な医療券・調剤券情報がない))。
3. その公費負担者番号、受給者番号では、まだ医療券・調剤券情報が登録されていない。

POWER5G クライアント自動アップデート

■ クライアント自動アップデートについて

PC 内にインストールされているクライアントモジュールの自動アップデートが行われます。今後、新しいクライアントモジュールのリリースが行われる際に以下の画面が展開します。


■ 自動アップデート画面

POWER5G 起動時に下図の画面が表示されます。「アップデートが完了しました。」が表示されるまでしばらくお待ちください。バージョンアップ完了後、自動で画面が閉じます。



■ 保険証 OCR プログラム更新画面

バージョンアップ完了後、保険証 OCR システムを導入されているユーザー様で保険証 OCR プログラムのバージョンが低い場合には、下図の OCR プログラム更新画面が表示されます。「更新を適用する」ボタンを押すとユーザーアカウント制御が表示される場合がありますので「はい」ボタンを押してください。

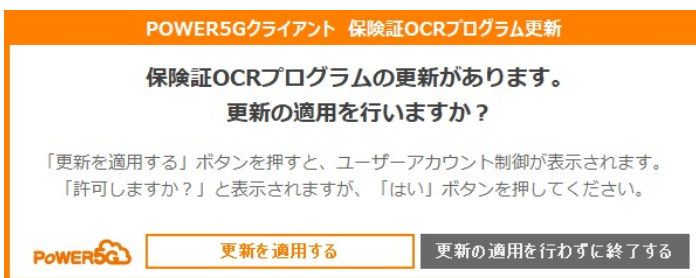

※ユーザーアカウント制御で「いいえ」ボタンを押したり、「更新の適用を行わずに終了する」ボタンを押した場合、保険証 OCR プログラムを更新するには手動での操作が必要になります。手動での更新操作を行う場合にはヘルプデスクまでご連絡ください。

■ バージョンアップが失敗した場合

バージョンアップに失敗したり、保険証 OCR プログラムの更新に失敗した場合には下図のメッセージが表示されます。これらのメッセージが表示されたり POWER5G を起動するたびにバージョンアップが実行される場合は問題が発生しているためヘルプデスクまでご連絡ください。

